


The logo features a central stylized figure with a circular head, split vertically into a golden-yellow left half and a grey right half. The figure's arms are raised, and its legs are spread apart. This central figure is superimposed on a background of flowing, wavy lines that also split into golden-yellow on the left and grey on the right.

INFORMATION MEDICINE®

HEALING FREQUENCIES

**Bedienungsanleitung
INFORMATION SPEAKER**



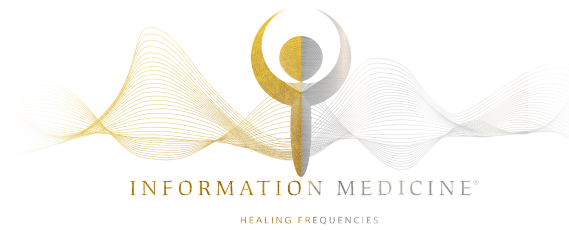

Inhaltsverzeichnis

Seite 3	Lieferumfang
Seite 4	Allgemeine Informationen
Seite 5	Beschreibung Information Speaker
Seite 6	Anschluss des Information Speaker Platzierung des Information Speaker
Seite 7	Lautstärkeeinstellung
Seite 8	Technische Spezifikationen
Seite 9	Garantiebedingungen
Seite 10	Reparatur Garantiezeitraum
Seite 11	Kontakt- und Informationsdetails

Lieferumfang



1 x 3,5-mm-Klinken-Audiokabel
3 Meter lang

of



1 x Information speaker




1 x 3,5-mm-Klinken-Audiokabel
auf USB-C Anschluss

of



1 x 3,5-mm-Klinken-Audiokabel
auf Lightning-Anschluss

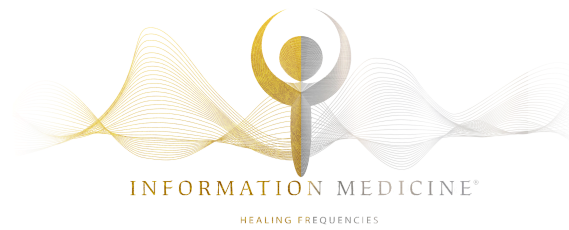

Allgemeine Informationen

Der Information Speaker wurde speziell für Klangtherapie mit harmonischen Frequenzen entwickelt.
Die Anwendung erfolgt über die Online-Streaming-Plattform von Information Medicine:

www.informationmedicine.org

Information Medicine unterstützt die Aktivierung der Selbstheilungskräfte und der inneren Intelligenz des Körpers – bei Menschen, Pflanzen und Tieren.

Die harmonischen Klänge „informieren“ den Körper mithilfe von Frequenzen in Form von Klang sowie elektromagnetischen Impulsen. Dadurch kann Heilung auf einer sehr tiefen Ebene von Körper, Geist und Seele stattfinden.

Die Klangtherapie mit harmonischen Frequenzen eignet sich sowohl zur präventiven Unterstützung der Gesundheit als auch zur Förderung von Vitalität, Belastbarkeit und Wohlbefinden. Sie kann außerdem eine wertvolle Unterstützung bei unterschiedlichen Beschwerden im Bereich von Körper, Geist und Seele sein – zum Beispiel bei der Erholung nach körperlichen Beschwerden oder Verletzungen sowie bei mental-emotionalen und energetischen Themen. Diese noch vergleichsweise neue Art der Anwendung betrachten wir als einen wichtigen Schritt hin zu einer ganzheitlichen Gesundheitsversorgung der Zukunft.

Je natürlicher und reiner der Informationsimpuls ist, desto besser kann der Körper ihn aufnehmen. Die Körperzellen erkennen die harmonischen Klänge als ihre „ursprüngliche Resonanz“ und nehmen genau die Informationen auf, die sie benötigen, um wieder in ein harmonisches Gleichgewicht zu gelangen. Die Qualität des Speakers sowie des verwendeten Audiokabels spielt dabei eine entscheidende Rolle und ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Therapieform.



Beschreibung Information Speaker

In Kombination mit dem mitgelieferten Premium-Audiokabel gewährleistet der Information Speaker eine optimale Übertragung der Inhalte von Information Medicine. Die Klangdateien werden dabei in Form von spürbaren und hörbaren harmonischen Frequenzen und Schwingungen weitergegeben.

Über unsere Website können bei Bedarf passende Audiokabel in Premium-Qualität bestellen. Wir führen AUX-Kabel mit 3,5-mm-Klinkenanschluss, USB-C-Anschluss sowie iPhone-Lightning-Anschluss. Ein Audiokabel sorgt für eine stabilere und klarere Übertragung der Klanginformationen als das kabellose Abspielen über Bluetooth oder WLAN. Ein Ende des Kabels wird in den Information Speaker gesteckt, das andere Ende in Ihr jeweiligen Endgerät.

Der **Information Speaker** ist im Grunde kein herkömmlicher Lautsprecher, sondern ein sogenannter Sound-Exciter. Er wurde dafür entwickelt, akustische Energie – also Klang und Vibration – über eine Kontaktfläche weiterzugeben, in diesem Fall über den Körper. Durch die übertragenen Schwingungen wird der Körper selbst zum Resonanzraum. Die Wirkung der harmonischen Frequenzen erfolgt daher nicht ausschließlich über das Hören mit den Ohren.

Der Information Speaker überträgt die harmonischen Informationen auf drei Ebenen:

- **über spürbare Vibrationen,**
- **über hörbare Klangfrequenzen sowie**
- **über elektromagnetische (lichtbasierte) Frequenzen.**

Als Kontakt-Speaker und Sound-Exciter ist das Gerät dafür konzipiert, direkt auf den Körper aufgelegt zu werden. An der Vorderseite befindet sich eine runde, bewegliche Platte – die Vibrationsfläche. Wird diese auf den Körper gelegt, breiten sich die Klangschwingungen von dort aus im ganzen Körper aus. Der Körper fungiert dabei als Resonanzraum, wodurch die Vibrationen alle Körperzellen erreichen und eine angenehme, wohltuende Erfahrung ermöglichen.



Anschluss des Information Speaker

Der Information Speaker wird mithilfe eines 3,5-mm-Audiokabel mit Ihrem Endgerät (PC, Laptop, Tablet oder Smartphone) verbunden. Um die Klangdateien von Information Medicine abzuspielen, muss das Gerät für Online-Streaming geeignet sein. Weitere Informationen zur Nutzung und Wiedergabe finden Sie auf unserer Website: www.informationmedicine.org

Platzierung des Information Speaker

Anwendung beim Menschen


Platzieren Sie den **Information Speaker** mit der Vibrationsseite auf dem Brustbereich, etwa auf Höhe des Thymusdrüse. Diese befindet sich ungefähr 2 cm unterhalb der kleinen lokal Vertiefung zwischen den Schlüsselbeinen. Alternativ kann der Information Speaker auch dort aufgelegt werden, wo er als angenehm oder unterstützend empfinden wird – beispielsweise auf dem Knie bei Kniebeschwerden. Für eine optimale Wirkung empfiehlt es sich, die Vibrationsfläche direkt auf die nackte Haut gelegt. Bitte beachten Sie, dass der Information Speaker nicht stoß- oder bruchstabil ist.

Anwendung bei Tieren

Platzieren Sie den Information Speaker mit der Vibrationsseite im Bereich des Übergangs von der Lendenwirbelsäule zum Kreuzbein. Dort ist häufig eine kleine Vertiefung im unteren Rücken tastbar. Alternativ kann das Gerät auch lokal bei Beschwerden eingesetzt werden, zum Beispiel direkt auf einer betroffenen Sehne.

Achten Sie darauf, den Information Speaker sicher zu platzieren oder zu befestigen, da er nicht stoß- oder bruchstabil ist.

Bei Pferden kann beispielsweise eine dünne Baumwoll-Sommerdecke oder Fliegendecke verwendet werden, an der eine kleine Tasche (z. B. aus einem Baumwollwaschlappen) angenäht wird, um den Information Speaker aufzunehmen. Bei sehr kleinen Tieren empfehlen wir aus praktischen Gründen, den Information Speaker nicht direkt auf dem Tier, sondern im Raum zu platzieren.

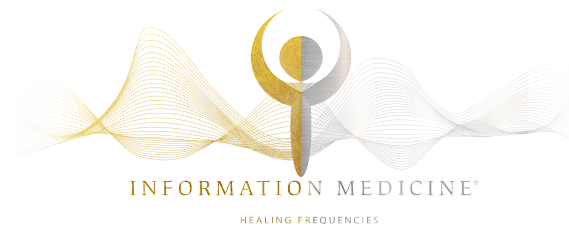

Lautstärkeeinstellung

Die Lautstärke des Information Speaker wird über das jeweilige Endgerät (PC, Laptop, Tablet oder Smartphone) geregelt. Es ist weder notwendig noch sinnvoll, eine sehr hohe Lautstärke einzustellen.

Die harmonischen Frequenzen sollten gut spürbar und leise hörbar sind, ohne zu reizen oder als unangenehm empfunden zu werden. Einige tiefere Töne sind kaum hörbar, andere treten deutlicher hervor. Dies variiert während der Wiedergabe der Klangdateien.

Wir empfehlen eine maximale Lautstärke von 65 Dezibel. Bei kleinen Kindern sowie bei jungen oder kleinen Tieren sollte die Lautstärke auf maximal 50 Dezibel begrenzt werden.

Falls erforderlich, kann die Lautstärke mithilfe einer Dezibelmeter-App auf dem Smartphone überprüft werden. Halten Sie das Smartphone dazu neben den Information Speaker, während dieser auf dem Körper platziert ist, und messen Sie die Lautstärke sowohl bei hohen als auch bei tiefen Tönen.

Wichtig ist vor allem:


- (1) dass die Vibrationsfunktion des Sound-Exciters gut spürbar ist und
- (2) dass die leise hörbaren harmonischen Klänge als angenehm empfunden werden.

Eine zu hohe Lautstärke kann als weniger angenehm wahrgenommen werden und dazu führen, dass die Informationen vom Körper schlechter aufgenommen werden. Die optimale Lautstärke kann daher individuell variieren.

Hinweis: Die Lautstärke- und Klangwahrnehmung des Information Speaker lässt sich nicht direkt mit der eines herkömmlichen Lautsprechers vergleichen. Der Information Speaker überträgt Klangschwingungen über die Vibrationsfläche und ermöglicht dadurch ein taktiles, also fühlbares Klangerlebnis.

Achtung:

Einige Smartphones erkennen den Information Speaker als Kopfhörer und begrenzen automatisch die Wiedergabelautstärke. Diese Einstellung kann bei Bedarf manuell in den Audio- oder Geräteeinstellungen angepasst werden.

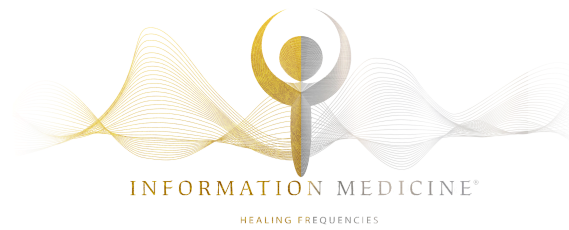

Technische Spezifikationen

- Integrierter Full-Range-Exciter-Speaker mit Neodym-Motor
- Schwingspule: 2,54 cm
- Belastbarkeit: 10 W RMS

Abmessungen: Ø 6,7 cm

Gewicht: 100 Gramm

Impedanz: 4 Ohm

Resonanzfrequenz: 306 Hz

Anschluss: 3,5-mm-Klinke

Audiowiedergabe: Mono

Interne Antenne: Ja – 2,4-GHz-WLAN-Innenantenne (5 dBi)

Integrierter Verstärker: Nein

Zur Reinigung kann der Information Speaker vorsichtig mit einem sauberen Tuch abgewischt werden, das leicht mit Isopropylalkohol (auch Isopropanol oder IPA genannt; erhältlich in Apotheken oder online) angefeuchtet ist.



Garantiebedingungen

Information Medicine BV garantiert, dass das Produkt frei von Herstellungs- und/oder Materialfehlern ist, unter der Voraussetzung, dass:

- das Produkt direkt über Information Medicine BV oder über einen autorisierten Fachhändler an Sie verkauft wurde;
- das Produkt im Neuzustand geliefert wurde;
- das Produkt im Neuzustand geliefert wurde;
- das Produkt unter normalen Bedingungen verwendet wurde.


Die Rechnung, die Sie nach der Bestellung und Bezahlung von uns erhalten, gilt gleichzeitig als Garantienachweis. Bitte bewahren Sie diese sorgfältig auf. Sollten Sie die Rechnung verloren haben, können Sie diese in Ihrem persönlichen Dashboard unter dem Punkt „Rechnungen“ erneut einsehen. Wenn Sie kein Benutzerkonto bei uns haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter contact@informationmedicine.org.

Innerhalb der Garantiezeit wird der Information Speaker kostenlos repariert oder ersetzt, falls eine Reparatur nicht möglich ist, durch ein gleiches oder gleichwertiges Produkt. Bei einem Garantiefall fallen keine Versandkosten an.

Wird eine Bestellung sichtbar beschädigt durch den jeweiligen Zustelldienst geliefert, nehmen Sie das Paket bitte nicht an und unterschreiben Sie nicht für den Empfang. Das Produkt wird automatisch an uns zurückgesendet, und wir sorgen für die Lieferung eines neuen Exemplars.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Schäden oder Defekte durch Fallenlassen, Stöße oder unsachgemäße Behandlung;
- Defekte durch unsachgemäßen Gebrauch, z. B. falsches Anschließen des Speakers oder Schäden durch Überlastung;
- Normale Abnutzung durch Gebrauch;
- Defekte durch nicht autorisierte Änderungen oder Reparaturen durch Dritte;
- Feuchtigkeits-, Wasser- oder Brandschäden;
- Schäden oder Defekte durch Blitzeinschlag sowie durch elektromagnetische Induktion infolge von Blitzeinwirkung.

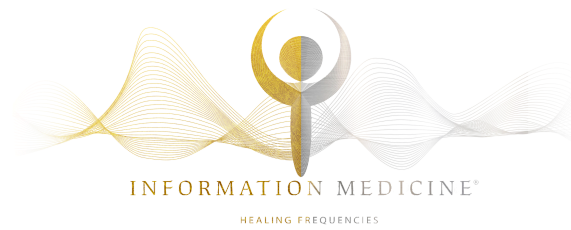

Reparatur

Natürlich ist es sehr ärgerlich, wenn ein Produkt, das Sie bei uns gekauft haben, defekt ist oder nicht (mehr) einwandfrei funktioniert. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter contact@informationmedicine.org. Unser Kundenservice informiert Sie darüber, wie die weitere Vorgehensweise aussieht.

Sollte das Produkt eingesendet werden müssen, senden Sie es nach Möglichkeit in der Originalverpackung zurück. Legen Sie bitte außerdem immer eine Kopie der Rechnung (als Kaufnachweis) sowie eine möglichst genaue Beschreibung des Problems bei.

Garantiezeitraum


Sollte das Produkt eingesendet werden müssen, senden Sie es nach Möglichkeit in der Originalverpackung zurück. Legen Sie bitte außerdem immer eine Kopie der Rechnung (als Kaufnachweis) sowie eine möglichst genaue Beschreibung des Problems bei.

Beim Kauf eines Produkts haben Sie immer Anspruch auf die gesetzliche Gewährleistung. Das bedeutet, dass Sie davon ausgehen dürfen, ein einwandfrei funktionierendes Produkt zu erhalten, das für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Funktioniert ein Produkt nicht ordnungsgemäß, haben Sie Anspruch auf kostenlose Reparatur, ein Ersatzprodukt oder eine Rückerstattung. Was Sie im Einzelnen erwarten dürfen, hängt von der Art des Produkts ab. Daher gibt es in den Niederlanden keine allgemein festgelegte gesetzliche Garantiefrist.

Im europäischen Recht ist jedoch eine feste Garantiezeit vorgesehen.

- In Übereinstimmung mit diesen Regelungen gewähren wir auf den Information Speaker eine Garantie von 24 Monaten, beginnend mit dem Kaufdatum, wie es auf der Rechnung angegeben ist.
- Tritt **innerhalb von 6 Monaten** nach dem Kauf ein Mangel am Produkt auf, liegt die Beweislast bezüglich der Produktmängelfreiheit bei uns, dem Verkäufer.
- Tritt ein Mangel **nach Ablauf von 6 Monaten** auf, liegt die Beweislast beim Käufer bzw. Verbraucher.
- Die Garantie gilt ausschließlich für den Information Speaker und nicht für das mitgelieferte Audiokabel.
- Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Information Speaker nicht stoß- oder bruchsicher ist. Schäden durch Fallenlassen oder Stöße sind daher von der Garantie ausgeschlossen.

Weitere Informationen zur Garantie unserer Produkte finden Sie in unseren Garantiebedingungen auf unserer Website: www.informationmedicine.org/algemenevoorwaarden/

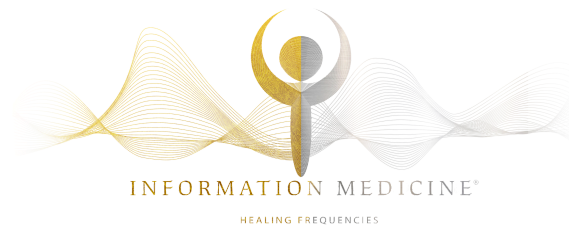

Kontakt- und Informationsdetails

Information Medicine BV

Bisschopsweg 2, 3732 HW De Bilt, Die Niederlande

Telefon: 085-124 90 18

E-Mail: contact@informationmedicine.org

Webseite: www.informationmedicine.org

Oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code mit Ihrem Mobilgerät.

